

Instrumental PERFECT-C®

Código	Descrição	Código	Descrição
SCCFI-011	Prova de Implante 5 x 12	SCCFI-033	Impactador de Enxerto
SCCFI-012	Prova de Implante 6 x 12	SCCFI-034	Base para Impactar Enxerto
SCCFI-013	Prova de Implante 7 x 12	SCCFI-035	Manopla Contra-Torque Tipo-S
SCCFI-014	Prova de Implante 8 x 12	SCCFI-036	Manopla Contra-Torque Tipo-L
SCCFI-015	Prova de Implante 5 x 14	SCCFI-037	Torquímetro
SCCFI-016	Prova de Implante 6 x 14	SCCFI-039	Caixa de Instrumentais
SCCFI-017	Prova de Implante 7 x 14	SCCFI-040	Caixa de Implantes
SCCFI-018	Prova de Implante 8 x 14	SCCFI-041	Chave Universal
SCCFI-021	Introdutor de Implante	SCCFI-042	Bainha
SCCFI-022	Punção Inicial	SCCFI-043	Impactador
SCCFI-023	Broca 14mm	SCCFI-044	Punção Inicial Curvado
SCCFI-024	Broca 16mm	SCCFI-045	Guia 050612
SCCFI-025	Broca 18mm	SCCFI-046	Guia 070812
SCCFI-030	Chave de Fenda	SCCFI-047	Guia 050614
SCCFI-031	Chave de Aperto Final	SCCFI-048	Guia 070814
SCCFI-032	Cabo Tipo Manopla com Engate Rápido		



Afastador Caspar

Parafuso de Fixação
do Afastador Caspar

Prova de Implante

Introdutor de
Implante

Punção Inicial

Broca

Chave de Fenda



Guia

Chave de Aperto
Final

Cabo Tipo
Manopla

Impactador de
Enxerto


Base para
Impactar Enxerto

Torquímetro

Manopla
Contra-Torque


PERFECT-C[®]

Sistema de Fusão Cervical

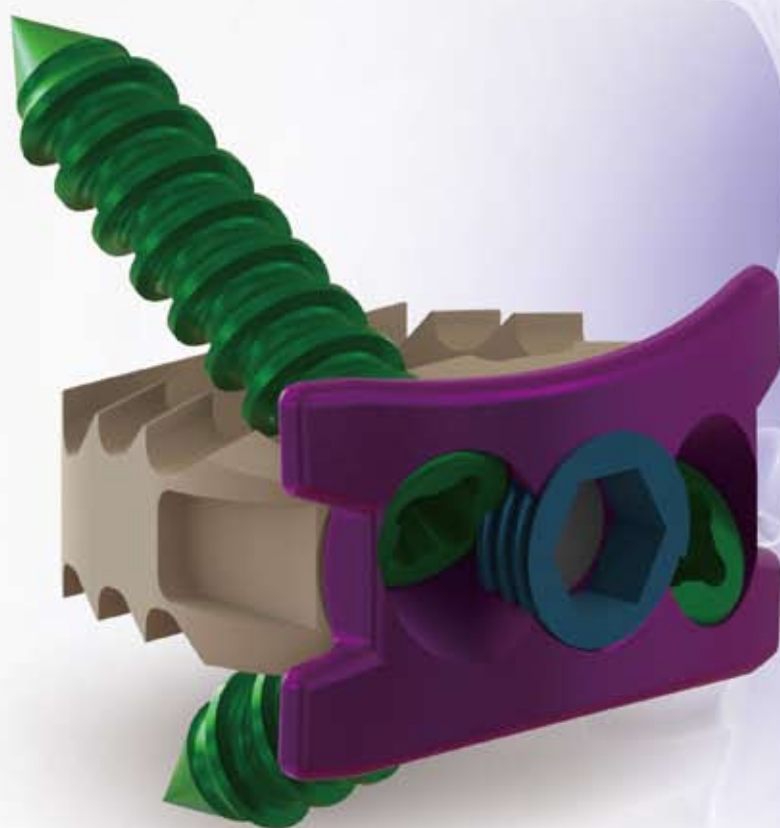

PERFECT-C®

Sistema de Fusão Cervical

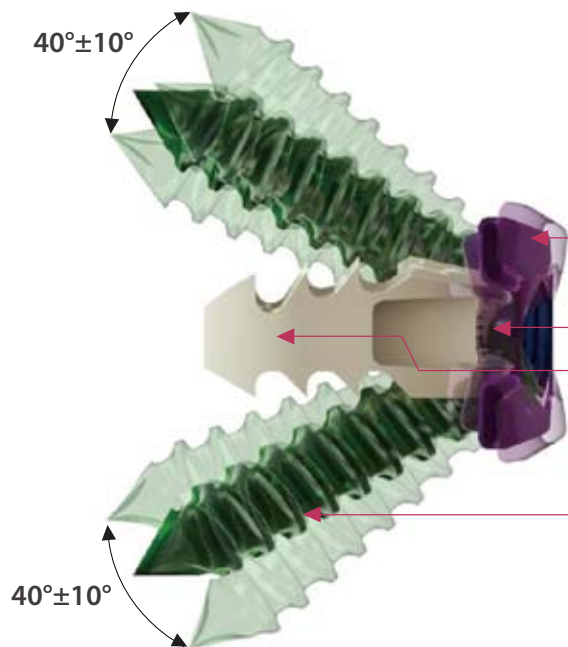

Características e Benefícios

- Placa de 1mm Ultra-Fina de Baixa Perfil
- Trava para Bloqueio do Parafuso
- Contacto Osso-Implante Optimal
- Ângulos Variados do Parafuso, 40°±10° para Fixação Dinâmica



O **PERFECT-C** é uma Sistema "stand-alone" de Fusão Cervical Anterior

Indicações

- DDD(Doença Degenerativa do Disco)
- Hérnia de Disco
- Mielopatia
- Radiculopatia
- Estenose do Canal Vertebral

Contraindicações


- Osteoporose
- Fraturas de Coluna Vertebral
- Tumor Espinhal
- Infecção

Benefícios


- Fixação Cortical
- Preservação da Lordose
- Prevenção da Ossificação Heterotópica
- Reduzir Blindagem de Tensões "Stress Shielding"

Implantes PERFECT-C®

Nº.	Código	A(mm)	L(mm)	C(mm)
1	CF051412	5,5	14	13,5
2	CF061412	6,5	14	13,5
3	CF071412	7,5	14	13,5
4	CF081412	8,5	14	13,5
5	CF051614	5,5	16	15
6	CF061614	6,5	16	15
7	CF071614	7,5	16	15
8	CF081614	8,5	16	15

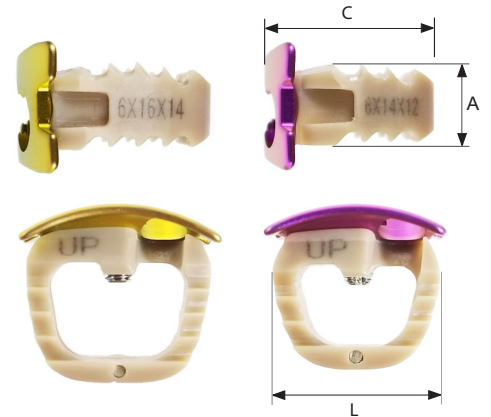

Nº.	Código	D(mm)	C(mm)
1	14	Ø3,5	14
2	16	Ø3,5	16
3	18	Ø3,5	18
4	14R	Ø3,9	14
5	16R	Ø3,9	16
6	18R	Ø3,9	18

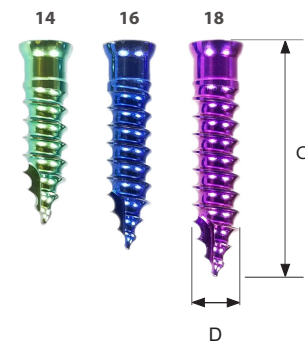

Nº.	Código	D(mm)	L(mm)
1	CAP	Ø5	1,25

